



Dossier d'information Euro Pharmat

Tubifast® 2-Way Stretch® ligne bleue (7,5 cm x 10 m)
- N°2438

DISPOSITIF MEDICAL

Remarque : Selon le dispositif médical (DM) concerné, ce dossier concernera une référence, un type ou une famille de DM




1. RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS CONCERNANT L'ENTREPRISE		Date de mise à jour : Aout 2023 Date d'édition : 2021	
1.1	Nom : Mölnlycke Health Care		
1.2	Adresse complète : 13 allée du Château Blanc - CS 70205 59445 Wasquehal Cedex	Tel: 03 20 12 25 55 e-mail : Site internet : www.molnlycke.fr	Fax : 03 20 12 25 46
1.3	Coordonnées du correspondant matériovigilance : Catherine BONTE 13 Allée du Château Blanc CS 70205 59290 WASQUEHAL cedex France	Tel : 03.20.12.25.55 e-mail : reclamation.qualite@molnlycke.com	

2. INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU EQUIPEMENT	
2.1	Dénomination commune : Bandage tubulaire en jersey extensible dans les 2 sens, en rouleau non stérile
2.2	Dénomination commerciale : Tubifast® 2-Way Stretch® ligne bleue (7,5 cm x 10 m), Bandage tubulaire en jersey léger et extensible dans les 2 sens, en rouleau non stérile
2.3	Code Cladimed* : M50BB *L'accès à la classification CLADIMED étant subordonné à une adhésion à l'association CLADIMED, renseigner cette cellule demeure facultatif.
2.4	Code LPPR* (ex TIPS si applicable) : 6 336 623 Tous nos produits sont disponibles en ville remboursés LPPR 100% (60% SS et 40% mutuelle). Seuls les conditionnements changent*. * « liste des produits et prestations remboursables » inscrits sur la liste prévue à l'article L 165-1
2.5	Classe du DM : Classe I Directive de l'UE applicable : Règlement européen des dispositifs médicaux 2017/745 (MDR) Numéro de l'organisme notifié : Auto-certification CE (conforme Annexe VII) Date de première mise sur le marché dans l'UE : 2008 (avec la technologie 2-Way Stretch®) Fabricant du DM : Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, S-40252 Göteborg, Suède

Dossier d'information Euro Pharmat

Tubifast® 2-Way Stretch® ligne bleue (7,5 cm x 10 m)
- N°2438


DISPOSITIF MEDICAL

<p>2.6</p>	<p>Descriptif du dispositif (avec photo, schéma, dimensions, volume, ...) : peut être relié au point 8 : selon fiche technique.</p> <p>Éléments à préciser : Bandage tubulaire en jersey léger et extensible dans les 2 sens, en rouleau non stérile, ligne bleu (7,5 cm x 10 m) Trousse : <input type="checkbox"/> Oui / <input type="checkbox"/> Non Si Oui : Composition de la trousse Insertion photos : relié au point 9</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">    </div>																		
<p>2.7</p>	<p>Références catalogue : peut être relié au point 8 : selon fiche technique</p> <p>Pour chaque référence préciser :</p> <p>REFERENCE : N°2438</p> <p>Conditionnement / emballages</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>UCD (Unité de Commande) :</td> <td>1</td> <td>Rouleau</td> </tr> <tr> <td>CDT (Multiple de l'UCD) :</td> <td>1</td> <td>Rouleaux</td> </tr> <tr> <td>QML (Quantité minimale de livraison) :</td> <td>30</td> <td>Rouleaux</td> </tr> </table> <p>Descriptif de la référence :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-left: 40px;"> Bandage tubulaire en jersey léger et extensible dans les 2 sens, en rouleau non stérile, ligne bleue (7,5 cm x 10 m) 7,5 cm x 10 m </div> <p>Caractéristiques de la référence :</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>Largueur Totale</td> <td>cm</td> <td>7,5</td> </tr> <tr> <td>Longueur Totale</td> <td>m</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Circonférence</td> <td>cm</td> <td>24 à 40</td> </tr> </table> <p>Étiquetage : copie (fac-similé du modèle d'étiquetage) Insertion image sous format PDF à insérer au point 9</p>	UCD (Unité de Commande) :	1	Rouleau	CDT (Multiple de l'UCD) :	1	Rouleaux	QML (Quantité minimale de livraison) :	30	Rouleaux	Largueur Totale	cm	7,5	Longueur Totale	m	10	Circonférence	cm	24 à 40
UCD (Unité de Commande) :	1	Rouleau																	
CDT (Multiple de l'UCD) :	1	Rouleaux																	
QML (Quantité minimale de livraison) :	30	Rouleaux																	
Largueur Totale	cm	7,5																	
Longueur Totale	m	10																	
Circonférence	cm	24 à 40																	

Dossier d'information Euro Pharmat

Tubifast® 2-Way Stretch® ligne bleue (7,5 cm x 10 m)
- N°2438

DISPOSITIF MEDICAL

<p>2.8</p>	<p>Composition du dispositif et accessoires :</p>  <p>Pour chaque élément ou composant préciser :</p> <table border="1" data-bbox="359 1153 1428 1254"> <tr> <td>ELEMENTS :</td> <td>MATERIAUX :</td> </tr> <tr> <td>Jersey tubulaire ---</td> <td>92% de visocse, 5% d'élasthane, 3% de polyamide (nylon)</td> </tr> <tr> <td>Ligne d'identification ---</td> <td>Code couleur par taille : ligne bleu</td> </tr> </table> <p>Substances actives : Sans objet</p>	ELEMENTS :	MATERIAUX :	Jersey tubulaire ---	92% de visocse, 5% d'élasthane, 3% de polyamide (nylon)	Ligne d'identification ---	Code couleur par taille : ligne bleu
ELEMENTS :	MATERIAUX :						
Jersey tubulaire ---	92% de visocse, 5% d'élasthane, 3% de polyamide (nylon)						
Ligne d'identification ---	Code couleur par taille : ligne bleu						
	<p>Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et/ou les produits administrés, précisions complémentaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Présence/Absence de latex ✓ Présence/Absence de phtalates (DHP) ✓ Présence/Absence de produit d'origine animale ou biologique (nature, ...) <p>Toutes mentions jugées utiles pour les précautions d'utilisation</p> <p>Dispositifs et accessoires associés à lister. (en cas de consommables captifs notamment) : Sans objet</p>						
<p>2.9</p>	<p>Domaine - Indications :</p> <p><u>Domaine d'utilisation</u> : Fixation secondaire ou protection des peaux fragilisées.</p> <p><u>Indications</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Système de maintien des pansements, sans épingle, sans sparadrap ni attache. ○ Protection sous plâtre ou sous bande de contention. ○ Traitement de l'eczéma atopique dans le cadre de la technique d'enveloppe humide ou sec. 						

<p>3. PROCEDE DE STERILISATION :</p>		
	<p>DM stérile :</p>	<p> OUI NON</p>
	<p>Mode de stérilisation du dispositif :</p>	



Dossier d'information Euro Pharmat

Tubifast® 2-Way Stretch® ligne bleue (7,5 cm x 10 m)

- N°2438

DISPOSITIF MEDICAL

Préciser les modes de stérilisation de chaque composant, s'il y a lieu. : sans objet

4. CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation & de stockage : 8-40°C, 30-70% d'humidité

Précautions particulières : Sans objet

Durée de la validité du produit : 3 ans

Présence d'indicateurs de température s'il y a lieu : Sans objet

5. SECURITE D'UTILISATION

5.1 **Sécurité technique** : Sans objet



5.2 **Sécurité biologique (s'il y a lieu)** : Sans objet

6. CONSEILS D'UTILISATION

6.1 **Mode d'emploi** : Mesurer la circonférence de la zone à couvrir et choisir en fonction la bande adaptée (cf. Taille et code couleur)

Pour le maintien de pansement :

A titre indicatif.



Choisissez la largeur de bandage qui convient, puis découpez le bandage en veillant à doubler la longueur requise.



Après avoir replié la longueur sur elle-même, étirez Tubifast® 2-Way Stretch®, puis le mettre en place sur la zone concernée.



Positionnez le bandage en débordant de plusieurs centimètres de chaque côté du pansement pour assurer un meilleur maintien.

Pour le traitement de l'eczéma atopique par la technique d'enveloppement sec ou humide:

- Mesurer la circonférence de la partie du corps à traiter. Choisir la bande adaptée (cf. code couleur) et découper deux bandes de la longueur nécessaire. Nettoyer la zone affectée et la sécher par tamponnement.
- Appliquer un traitement local sur les zones sérieusement touchées, en fonction des recommandations médicales.
- Appliquer un émollient adapté sur la peau en étalant du haut vers le bas.
- Tremper la première couche de Tubifast® 2-Way Stretch®, dans de l'eau chaude, l'essorer et l'appliquer lorsqu'elle est encore chaude et humide.
- Poser la deuxième bande de Tubifast® 2-Way Stretch® sèche par-dessus.

L'alternative à cette technique est d'utiliser une seule bande Tubifast® 2-Way Stretch® sèche posée directement sur l'émollient afin de le garder en place plus longtemps.

Renouvellement :

Tubifast 2-Way Stretch peut être laissé en place plusieurs jours. Il peut être lavé en machine (T° < 40°). Il doit être changé lorsqu'il est souillé par des fluides organiques ou lorsque ces propriétés



Dossier d'information Euro Pharmat

Tubifast® 2-Way Stretch® ligne bleue (7,5 cm x 10 m)

- N°2438

DISPOSITIF MEDICAL

	élastiques deviennent insuffisantes.
6.2	Indications : <ul style="list-style-type: none">○ Système de maintien des pansements, sans épingle, sans sparadrap ni attache.○ Protection sous plâtre ou sous bande de contention.○ Traitement de l'eczéma atopique dans le cadre de la technique d'enveloppe humide ou sec.



Dossier d'information Euro Pharmat

Tubifast® 2-Way Stretch® ligne bleue (7,5 cm x 10 m)
- N°2438

DISPOSITIF MEDICAL

6.3	Précautions d'emploi : <ul style="list-style-type: none">• Enveloppement sec ou humide : si l'eczéma s'aggrave ou s'infecte, cesser le traitement et consulter un médecin.• Eviter les flammes et toutes sources d'étincelles, notamment lors d'une utilisation avec des produits à base de paraffine.• Non stérile. La stérilisation de Tubifast® 2-Way Stretch® n'a pas été testée et n'est pas recommandée.• Ne pas utiliser après la date d'expiration. Si le produit est utilisé après la date d'expiration, ses performances ne sont plus garanties.
6.4	Contre- Indications : Sans objet.

7. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LE PRODUIT		
<u>Bibliographie, rapport d'essais cliniques, ou d'études pharmaco-économiques, amélioration du service rendu : recommandations particulières d'utilisation (restrictions de prise en charge, plateau technique, qualification de l'opérateur, etc) ... :</u>		
<h3>CARACTERISTIQUES PHYSIQUES (TESTS EN LABORATOIRE)</h3>		
Propriété	Méthode	Valeur / Résultat
Etirement longitudinal	SM 83	35 à 65%
<h3>BIOCOMPATIBILITÉ</h3>		
L'innocuité de Tubifast® 2-Way Stretch® a été démontrée pour les tests suivants :		
Tests	Méthodes Utilisées	
Cytotoxicité	ISO 10993-1 : 2003	
Sensibilisation cutanée	ISO 10993-1 : 2003	
Irritation ou réactivité intra-cutanée	ISO 10993-1 : 2003	

8. LISTE DES ANNEXES AU DOSSIER (S'IL Y A LIEU)	
	<ul style="list-style-type: none">- Etiquette et étiquette de traçabilité (le cas échéant) : cf. paragraphe 9- Brochure - sur demande- Manuel /notice d'utilisation - dans chaque boîte, cf. ci-dessous- Fiche technique fournisseur - sur demande


Dossier d'information Euro Pharmat

Tubifast® 2-Way Stretch® ligne bleue (7,5 cm x 10 m)

- N°2438

DISPOSITIF MEDICAL

Tubifast® WITH 2-WAY STRETCH™ TECHNOLOGY



1

Le bandage Tubifast 2-Way Stretch est un bandage tubulaire léger qui épouse les contours du corps et qui peut être utilisé pour maintenir les pansements en place, dans des régions affectées par des problèmes dermatologiques, ou comme protection sous un plâtre. Pour mettre Tubifast 2-Way Stretch en place, vous devez d'abord recouvrir d'une paire de doigts et de vos mains le bout d'un doigt de couper le bandage à la longueur requise.



2

Si vous l'utilisez pour maintenir un pansement en place, étirez Tubifast 2-Way Stretch sur vos mains et appliquez pendant la mesure effectuée. S'il est recouvert la totalité du membre, il suffit d'attacher ou de recoudre Tubifast 2-Way Stretch sur le membre, comme un tissu.



3

Tubifast 2-Way Stretch recouvre le pansement en exerçant une pression légère et uniforme, sans restriction. Vous pouvez le presser en douceur. Évitez, en particulier sur les articulations pour le bloquer, un geste trop brusquement en place, ou bien vous pouvez ramener les bandes avec le bandage. Quelle que soit la méthode utilisée, Tubifast 2-Way Stretch est rapide et facile à mettre en place et confortable à utiliser en place, sans restriction et compressible.

Mise en place sur une main



1

Mesurez la distance de votre poignet à un niveau juste au-dessus du poignet, doublez et étirez, découpez deux trous sur 8 cm environ à partir de l'extrémité.



2

Enfilez Tubifast 2-Way Stretch sur la main et sur le poignet, le pouce et le petit doigt passant dans les trous formés à cet effet.



3

Répétez le reste du bandage sur lui-même, les trois doigts du milieu passant dans l'autre trou. Le bandage et le pansement sont alors fermement bloqués en place.

Mise en place d'un débandeur



1

Découpez une section de Tubifast 2-Way Stretch de taille adaptée au corps, à une longueur correspondant à la distance de l'épaule à la taille du patient. Découpez des trous à environ 15 cm de haut, sur 4-5 cm environ à partir de chaque côté du bandage.



2

Enfilez Tubifast 2-Way Stretch par-dessous la tête. Les bras passant dans les trous formés à cet effet.



3

Tirez sur Tubifast 2-Way Stretch pour le positionner comme un débandeur. Cette procédure de pose est idéale pour maintenir des pansements en place sur le poignet ou sur le dos, et en dermatologie.

Débandeur poitrine



1

Mettez en place un bandage de taille adaptée au corps, en suivant la procédure de mise en place précédente, et enfiler un bandage Tubifast 2-Way Stretch de taille adaptée au bras sur le bras.



2

Découpez le dessous et le dessus du bandage passé sur le bras, pour former deux bandes dans la section correspondant au bras. Découpez des trous dans le dos et dans le devant du débandeur, pour bloquer les bandes en place.



3

Faites passer les bandes dans les trous du bandage Tubifast 2-Way Stretch de taille adaptée au corps et attachez-les, vous obtenez ainsi un débandeur à manches, idéal pour une utilisation en dermatologie ou comme bandage tubulaire sous un plâtre.

Pose d'un bandage sur la hanche



1

Découpez une section de Tubifast 2-Way Stretch de taille adaptée au bras, à une longueur correspondant à la distance de la taille à la cuisse de patient, et découpez un trou à environ 15 cm de haut.



2

Enfilez Tubifast 2-Way Stretch sur la jambe affectée et faites passer l'autre jambe dans le trou formé à cet effet.



3

Tubifast 2-Way Stretch maintiendra alors fermement un pansement en place sur la région de la hanche.

Mise en place sur la tête



1

Mesurez la distance entre la oreille et le dessous de la tête et doublez. Ajoutez une petite longueur supplémentaire (2-4 cm) et découpez. Répétez le bandage de façon à obtenir deux trous à égale longueur et découpez un trou à 8-9 cm du bas, sur 3-4 cm de haut.



2

Enfilez le bandage par-dessous la tête, la tête passant par le trou. Faites un tour complet avec le reste du bandage et répétez l'opération avec le deuxième épaulement.



3


Le bandage est maintenant en place sur la tête, et le pansement est fermement maintenu en place.

Pose d'un pansement sur la patricie



1

Découpez une section de Tubifast 2-Way Stretch à une longueur correspondant à la distance entre la taille et le milieu de la cuisse, et découpez un trou sur la moitié de Tubifast 2-Way Stretch (environ 15 cm vers le haut).



2

Enfilez Tubifast 2-Way Stretch pour le mettre en place, les deux jambes passant par le trou, et la bande qui reste se trouvant derrière.



3

Faites passer la bande entre les jambes, et découpez des trous dans la section correspondant au corps. Faites passer les deux extrémités des bandes dans les trous et attachez-les, en bloquant ainsi le pansement en place sur la patricie.



Dossier d'information Euro Pharmat

Tubifast® 2-Way Stretch® ligne bleue (7,5 cm x 10 m)
- N°2438

DISPOSITIF MEDICAL

BANDAGE TUBULAIRE EXTENSIBLE

Tubifast 2-Way Stretch®

Utilisation de Tubifast 2-Way Stretch® pour le maintien de pansement et la protection cutanée.

1. Choisir la bande adaptée selon le schéma coloriel et découper si nécessaire en tenant compte d'un large débordement de part et d'autre du pansement pour un meilleur maintien.
2. Etirer Tubifast 2-Way Stretch® avec les mains et couvrir le pansement.
3. Tubifast 2-Way Stretch® peut être appliqué en double couche pour plus de sécurité.

Utilisation de Tubifast 2-Way Stretch® pour l'enveloppement des zones à traiter.

1. Choisir la bande adaptée au recouvrement de la zone à traiter et la découper si nécessaire.
2. Nettoyer la zone à traiter et la sécher par tamponnement avec des compresses.
3. Si prescription médicale d'un traitement local, appliquer le traitement sur la zone à traiter.
4. Appliquer un émollient conseillé par votre médecin sur la zone à traiter en l'étalant du haut vers bas.
5. Appliquer Tubifast 2-Way Stretch® sur la zone à traiter.
6. Pour un enveloppement humide, appliquer Tubifast 2-Way Stretch® en double épaisseur. Tremper la première couche dans de l'eau chaude, l'essorer et l'appliquer lorsqu'elle est encore chaude et humide. Ensuite appliquer Tubifast 2-Way Stretch® sec par-dessus.
7. L'alternative à cette technique est d'utiliser une seule bande Tubifast 2-Way Stretch® sèche posée directement sur l'émollient afin de le garder en place plus longtemps.

Tubifast 2-Way Stretch® est disponible en plusieurs largeurs. Veuillez consulter la boîte pour de plus amples informations.

Si le produit est souillé par des fluides organiques, le jeter conformément à la réglementation en vigueur et le remplacer.

Recommandations et précautions d'emploi.

Enveloppement sec ou humide: si votre eczéma s'aggrave ou s'infecte, cessez le traitement et consultez votre médecin immédiatement.

Ce produit et son emballage ne contiennent pas de latex.

Evitez les flammes et les sources d'inflammation, notamment lors d'une utilisation avec des produits à base de paraffine.

Composition en fibres: Viscose, élasthanne, polyamide.




Dossier d'information Euro Pharmat

Tubifast® 2-Way Stretch® ligne bleue (7,5 cm x 10 m)

- N°2438

DISPOSITIF MEDICAL

9. IMAGES (S'IL Y A LIEU)

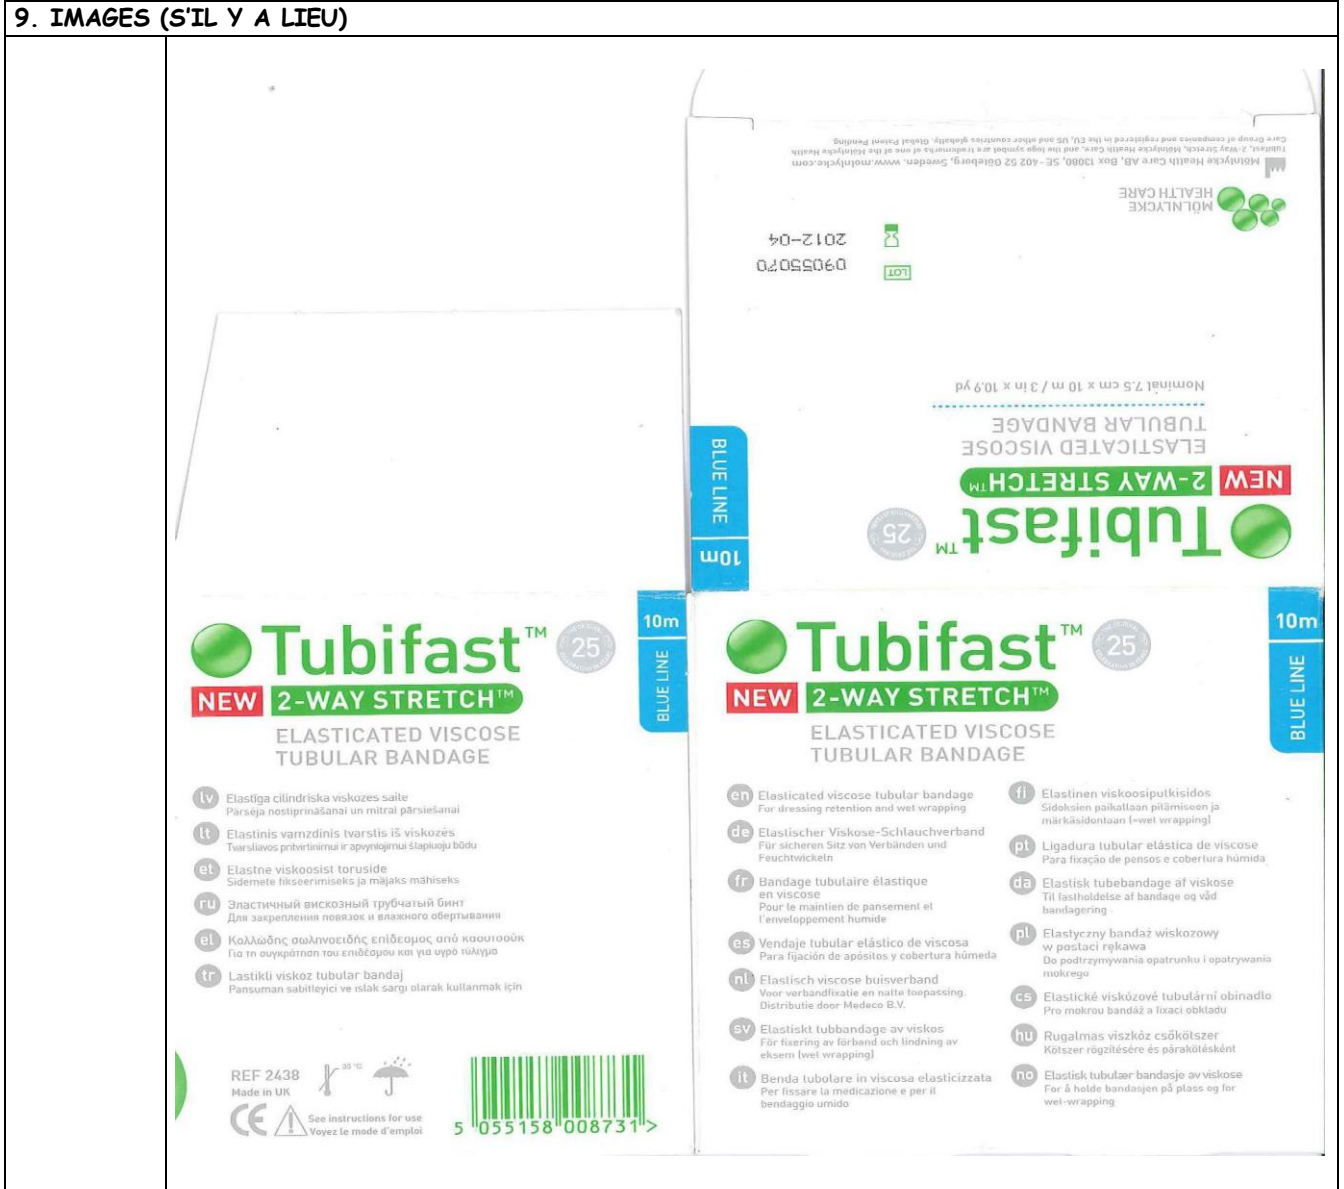



Dossier d'information Euro Pharmat

Tubifast® 2-Way Stretch® ligne bleue (7,5 cm x 10 m)
- N°2438

DISPOSITIF MEDICAL

11. TABLEAU RECAPITULATIF DES ETUDES		
	Etude 1	Etude 2
Titre de l'étude	TUBIHOP	TeMpO
Centres	CHU, CHR, CLCC...	304 infirmières libérales ville
Types d'étude	Etude de série cas	Etude observationnelle
Objectif de l'étude	Evaluation de Tubifast 2-Way Stretch en médecine hospitalière	Evaluer la facilité et la praticité de l'association Mepilex + Tubifast dans le cadre des soins infirmiers à domicile
Produit testé	Tubifast 2-Way Stretch	Gamme Mepilex + Tubifast 2-Way Stretch
Nombres de Patient(e)s	280	2 401
Critères D'évaluation : Efficacité	Cf. rapport TUBIHOP	Cf. rapport TeMpO
Critères D'évaluation : Tolérance	Cf. rapport TUBIHOP	Cf. rapport TeMpO
Résultats : Efficacité	Cf. rapport TUBIHOP	Cf. rapport TeMpO
Résultats : tolérance	Cf. rapport TUBIHOP	Cf. rapport TeMpO