Mepilex® Lite

Dünner, abdeckender, hoch flexibler Schaumverband zum Schutz der Haut und zur Versorgung nicht oder leicht exsudierender Wunden.

Wundauflage aus Polyurethanschaum

- Absorbiert Exsudat[5,10,11]
- Gute Absorption unter Kompression[8]
- Hohe Anpassungsfähigkeit[6,8,10–12]
- Rutscht nicht unter dem Verband und kann auf die gewünschte Größe zugeschnitten werden

Safetac®-Schicht

- Weniger Schädigung und weniger Schmerzen beim Verbandwechsel[1–9]
- Haftet nicht am feuchten Wundbett,[1,8] sondern nur auf trockener Haut
- Angenehmes Tragegefühl[6,10,11,17] und sanfte Haftung bei einer guten Haftfähigkeit[6,7,23]
- Versiegelt die Wundränder und reduziert das Mazerationsrisiko[9,10]

Trägerfolie aus Polyurethan

- Atmungsaktiv[8]
- Wasserabweisend[25]

Einsatzmöglichkeiten zum Schutz der Haut bei der Verwendung medizinischer Geräte:

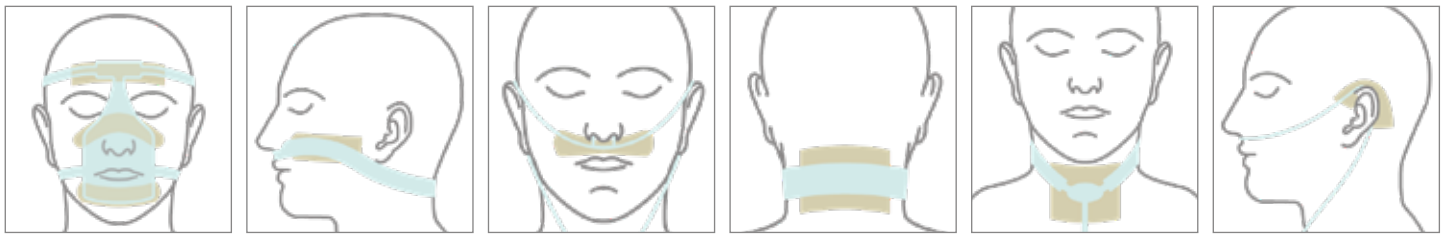

Zuschnittsvorlagen:

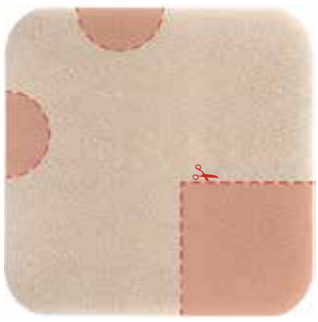

Beatmungsmaske

Tracheostoma

Beatmungsmaske

Sauerstoffbrille

Mölnlycke®

Mepilex® Lite Anwendungsleitfaden

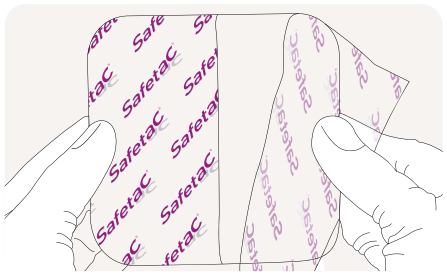

1. Reinigen Sie die Wunde gemäß der klinischen Praxis. Trocknen Sie die Wundumgebungshaut gründlich. Wählen Sie eine geeignete Verbandgröße. Der Verband sollte die trockene wundumgebende Haut bei kleinen Größen (bis zu 12,5 × 12,5 cm) um mindestens 1–2 cm und bei großen Größen um 3–5 cm bedecken. Bei Bedarf kann der Verband auf verschiedene Wundformen und -orte zugeschnitten werden. Entfernen Sie die erste Schutzfolie.

2. Entfernen Sie die restliche Schutzfolie und streichen Sie den Verband auf der Haut glatt. Bringen Sie die haftende Seite auf die Wunde auf. Den Verband nicht dehnen.

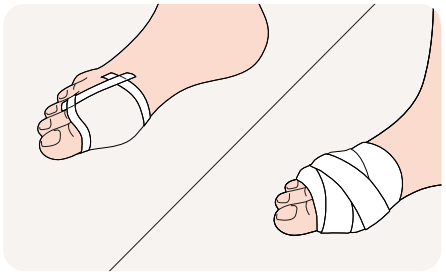

3. Fixieren Sie Mepilex® Lite bei Bedarf mit einem Verband oder einer anderen Fixierung.

So funktioniert Mepilex® Lite

Mepilex® Lite ist ein dünner und sehr anpassungsfähiger Schaumverband, der Exsudat absorbiert und ein feuchtes Wundmilieu aufrechterhält. Die Safetac®-Schicht bildet eine Versiegelung um die Wundränder herum und verhindert so das Austreten von Exsudat auf die wundumgebende Haut, wodurch das Mazerationsrisiko minimiert wird. Die Safetac®-Schicht sorgt für atraumatische Verbandwechsel. Mepilex® Lite kann auf verschiedene Wundformen und -orte zugeschnitten werden.

Vorteile von Mepilex® Lite

- Minimieren von Schmerzen und Traumata beim Verbandwechsel[1-9]
- Bleibt an Ort und Stelle und wirkt wie eine „Dritte Hand" beim Verbandwechsel und beim Anlegen von Kompressionsverbänden.[7,8,23]
- Fördert den Patientenkomfort; dünn und sehr angenehm zu tragen[6,10,11,17-20]
- Kann zur Behandlung von strahleninduzierten Hautschäden verwendet werden[17-20,27] und während der Strahlentherapie (mit den üblichen angewandten Energiebereichen und absorbierten Hautdosen) belassen werden[18,19]
- Gut geeignet zur Verwendung unter Kompressionsverbänden[8]
- Kann auf verschiedene Wundformen und schwierig zu versorgende Stellen zugeschnitten werden[6]
- Kann je nach Zustand der Wunde oder gemäß anerkannter klinischer Praxis mehrere Tage lang auf der Wunde verbleiben[7,8,10,21,23]
- Kann ohne Verlust der Hafteigenschaften angehoben und reappliziert werden[6]
- Geringes Potenzial für Hautreizungen und Allergien[2,18,22]

Anwendungsbereiche

Mepilex® Lite Verbände schützen nachweislich auch empfindliche Haut vor äußeren Kräften wie Reibung und Druck, die auch durch die Verwendung von Medizinprodukten entstehen.[24,26]

Mepilex® Lite wurde für die Behandlung einer Vielzahl von nicht bis schwach exsudierenden Wunden entwickelt, darunter chronische Wunden wie Ulzera Cruris, Diabetische Fußulzerationen oder Dekubitus, oberflächliche Verbrennungen, strahleninduzierte Hautschäden und Epidermolysis Bullosa. Mepilex® Lite kann auch als Schutz für beschädigte und/oder empfindliche Haut verwendet werden.

Hinweis

Wenden Sie sich bei Anzeichen einer klinischen Infektion an medizinisches Fachpersonal, um eine angemessene Behandlung zu erhalten.

Bestellinformationen

Home Care

Art.-Nr.	Größe	PZN/Packung	Stück/Packung	Stück/Karton
28 40 10	7,5 x 8,5 cm	03 64 24 43	5	70
28 41 10	12,5 x 12,5 cm	03 64 27 27	5	50
28 43 10	17,5 x 17,5 cm	03 64 27 79	5	35
28 45 00	20 x 50 cm	09 89 16 96	4	24

Klinik

Art.-Nr.	Größe	Stück/Packung	Stück/Karton
28 40 00	6 x 8,5 cm	5	70
28 41 00	10 x 10 cm	5	50
28 43 00	15 x 15 cm	5	30
28 45 00	20 x 50 cm	4	24

Steril – einzeln verpackt

Referenzen: 1. Zheng XP, Huang GY, Chang F, Qian MY, Xia ZF, Xiao SC. Curative effect of soft silicone dressing combined with calcium alginate dressing in treating skin graft donor sites of burned patients. Academic Journal of Second Military Medical University. 2016;37(11):1321-4. 2. Schumann, H., Beljan, G., Hoping, D., Bruckner-Tuderman, L. Atraumatic dressings in fragile skin conditions: use of the soft silicone dressing (Mepilex®) in hereditary and acquired bullous skin disease. Poster presentation. EWMA, 2005. 3. White R. A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK 2008; 4(1):14-22. 4. Upton, D., Solowiej, K. The impact of atraumatic vs conventional dressings on pain and stress. Journal of Wound Care 2012 21(5):209-215. 5. Eytier C, Gazeau E, Beneteau G, Verfaillie G. Convenience and tolerance of the combination of a soft silicone foam dressing and a two-way stretch tubular bandage in the management of local wounds. Journal des plaies et cicatrisations 2013;18(88):38-44. 6. Mölnlycke Health Care. Data on file. 2006. 7. Zhang Y, Xing SZ. Treatment of Diabetic Foot Ulcers using Mepilex® Lite Dressings: A Pilot Study. Experimental and Clinical Endocrinology and Diabetes: official journal, German Society of Endocrinology [and] German Diabetes Association. 2014;122(4):227-30. 8. Mölnlycke Health Care. Data on file. 2016. 9. Khramilin V. Mepilex® Lite/EM in the treatment of diabetic foot ulcer. Poster presentation. EWMA, 2006. 10. Meuleneire, F., and Fostier, A. Local treatment of heel pressure ulcers with a silicone foam dressing. Poster presentation. WUWHS, 2008. 11. Mölnlycke Health Care. Data on file. 2005. 12. Perez YP, Carmona JA, Perez IL, Garcia CM. Prevention and treatment of radiodermatitis using a non-adhesive foam dressing. Journal of Wound Care 2011;20 (3):130-135. 13. Gee Kee E et al. Randomized controlled trial of three burns dressings for partial thickness burns in children. Burns. 2015. 14. David, F. et al. A randomised, controlled, non-inferiority trial comparing the performance of a soft silicone-coated wound contact layer (Mepitel One) with a lipidocolloid wound contact layer (UrgoTul) in the treatment of acute wounds.International Wound Journal, 2017. 15. Meaume S. et al. A study to compare a new self-adherent soft silicone dressing with a self-adherent polymer dressing in stage II pressure ulcers. Ostomy Wound Management, 2003. 16. Meaume S. et al. A study to compare a new self-adherent soft silicone dressing with a self-adherent polymer dressing in stage II pressure ulcers. Ostomy Wound Management, 2003. 17. Poonam P. The Effect of Mepilex® Lite Dressings on Acute Radiation-Induced Skin Reactions in Women Receiving Post-Mastectomy Chest wall Irradiation (Thesis, Bachelor of Radiation Therapy with Honours). University of Otago. 2013. 18. Diggelmann KV, Zytkovicz AE, Tuaine JM, Bennett NC, Kelly LE, Herst PM. Mepilex ®Lite dressings for the management of radiation-induced erythema: a systematic inpatient controlled clinical trial. British Journal of Radiology. 2010;83(995):971-8. 19. Paterson DB, Poonam, P., Bennett, NC, Peszynski, RI, Van Beekhuizen, MJ, Jasperse, M, Herst, PM. Randomized intra-patient controlled trial of Mepilex® Lite dressings versus aqueous cream in managing radiation-induced skin reactions post-mastectomy. Journal of Cancer Science and Therapy. 2012;4 (11):347-56. 20. Sharp L et al. An open non-randomised case study to evaluate a new soft silicone dressing, Mepilex® Lite/EM®, for patients with radiation skin reactions Poster presentation. SAWC, 2004. 21. Mölnlycke Health Care. Data on file. 2014. 22. Zhong WH, Tang QF, Hu LY, Feng HX. Mepilex® Lite dressings for managing acute radiation dermatitis in nasopharyngeal carcinoma patients: a systematic controlled clinical trial. Medical Oncology (Northwood, London, England). 2013;30(4):761. 23. Eager CA. Comparison of two foams through the measurement of healing time, frequency of dressing changes and peri wound status. Poster presentation. Advanced Wound Care and Medical Research Forum on Wound Repair, 2001. 24. Boesch RP, Myers C, Garrett T et al. Pediatrics. 2012; 129: e792-e797. 25. Mölnlycke Health Care. Data on file. 2018. 26. Peko Cohen L, Ovadia-Blechman Z, Hoffer O, Gefen A. Dressings cut to shape alleviate facial tissue loads while using an oxygen mask. Int Wound J. 2019;1–14. 27. Perez YP, Carmona JA, Perez IL, Garcia CM. Prevention and treatment of radiodermatitis using a non-adhesive foam dressing. Journal of Wound Care. 2011;20:130–5.

Haftungsausschluss: Die prophylaktische Verwendung von Verbänden zur Verringerung des Risikos von druckbedingten Verletzungen im Zusammenhang mit Medizinprodukten ist gut dokumentiert, jedoch wurde ihre Verwendung unter PSA hinsichtlich der Aufrechterhaltung einer Abdichtung und der potenziellen Auswirkungen auf die Virusübertragung nach unserem Wissen weder von Mölnlycke noch von anderen getestet.

Erfahren Sie mehr unter www.molnlycke.com/de-de

Mölnlycke Health Care GmbH, EUREF-Campus Düsseldorf, EUREF-Campus 1B, 40472 Düsseldorf, Telefon: 0211 92088-0 Mölnlycke Health Care, Exufiber® und Hydrolock® sowie die entsprechenden Logos sind weltweit eingetragene Marken eines oder mehrerer Mitglieder der Mölnlycke Health Care Unternehmensgruppe. © 2026 Molnlycke Health Care AB. Alle Rechte vorbehalten. DWC0248 / Stand: Mai 2026

Mölnlycke®